

バイオガス設備実験装置概要

投入口
キャップをする



投げ込みヒーター
酸発酵の温度管理35℃前後



酸発酵槽
常に種菌を残しておく




ミストセパレーター
ガスホルダー



循環ポンプ
ポンプで定期的に攪拌



温度計
37℃前後をキープ

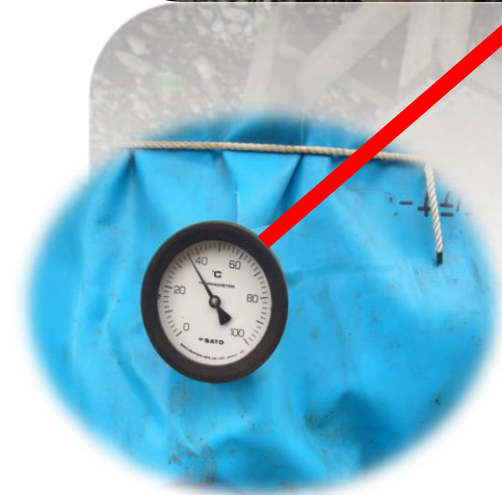

廃液口
液肥に利用

